AC09 – APPARATO PER LA CALIBRAZIONE DI BUNSEN per fiamme da 20 e 125 mm, secondo ASTM D 5207	**SCHEDA TECNICA**

Apparato completo che consente di eseguire la calibrazione di Bruciatori riferibili a diversi standard.

Il Calibratore fornisce la contropressione e velocità di flusso del gas di alimentazione per ottenere una fiamma di prova da 20 e 125 millimetri, secondo il metodo ASTM D5207

Seguendo la procedura si ottiene la conferma del profilo di flusso di calore della fiamma.

Caratteristiche tecniche del Controller:

Equipaggiato con strumenti digitali di misura

- Flussimetro MASSIVO, Misuratore di portata gas da 0 a 1020 ml/min 23°C
  0,1 Mpa con una precisione di ± 1%
- Manometro adatto alla misura di pressione nel campo da 0 a 0,1 Mpa
- 1 valvola di comando per regolare le portate di gas
- Controller con Touch screen a colori per rilevare in modo automatico la velocità di salita della temperatura del blocco di rame.
  Il timer si avvia quando la temperatura del sensore raggiunge 100 ° C e si ferma quando raggiunge i 700°C.

- Dimensioni: mm 360 x 300 x 240 h
- Alimentazione: 230V 50Hz
- Gas: Metano o Propano

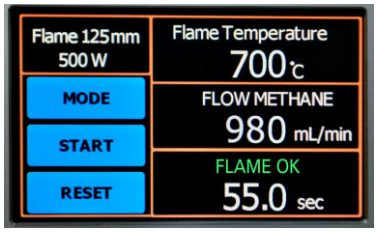

Accessori in dotazione:

- 1 bunsen∅ 9,5 mm (ASTM D 5025)
- 2 Sensori termici:
  - termocoppia tipo K - 0,5 mm completa di sensore in rame ∅ 9,0 mm (per fiamma da 125 mm)
  - termocoppia tipo K - 0,5 mm completa di sensore in rame ∅ 5,5 mm (per fiamma da 20 mm)
- Colonna stativo di supporto con pinza per i sostegno della termocoppia

Norme di Riferimento	
ASTM	D 5025
UL	94
CEI	60695-11-3 (500watt), 60695-11- 4(50watt)

Codice	**Descrizione**
10091309	Apparato per calibrazione di bunsen (AC09)

	Dotazione
10105403	Termocoppia K con blocco rame da 9 mm
10105405	Termocoppia K con blocco rame da 5,5 mm
10109001	Colonna stativo di supporto
78003775	Bunsen diam. 9,5 mm

© NOSELAB ATS s.r.l.
Via Garibaldi 144 -20834 Nova Milanese (MB) ITALY
tel.: 0362 367454 - fax: 0362 41357
info@noselab-ats.com - www.noselab-ats.com
rev.6-2019 – Data subject to change.